



T.C.  
VAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Van Gevaş Devlet Hastanesi

VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ - VAN GEVAŞ DEVLET  
HASTANESİ

05/10/2021 14:39 - E-37150567 - 949 - 1146



00149348224

Sayı : E-37150567-949  
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMA

Hastanemizin ihtiyacı olan CR GÖRÜNTÜLEME CİHAZI YEDEK PARÇA alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarımızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CR KASET TARAYICI SENSÖR DEDECTÖR (CARESTREAM MARKA CR 975/MAX MODEL CR KASET TARAYICI SENSÖR)	2	ADET		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi: 07.10.2021 Saat: 10:30

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 ( Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR  
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: c8f9f013-0308-4944-a097-6c5412c2e25f Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Gevaş Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Telefon: Faks No: 6122066

e-Posta: [ayhan.cevik1@saglik.gov.tr](mailto:ayhan.cevik1@saglik.gov.tr) İnternet Adresi: <https://gevasdh.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Ayhan ÇEVİK

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

Telefon No: (0 432) 612 20 65




**GEVAŞ DEVLET HASTANESİ**  
**CARESTREAM MARKA CR 975/MAX MODEL CR KASET**  
**TARAYICI CİHAZA UYUMLU**  
**SENSÖR DETECTOR & EMITTER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1) teklif edilecek parça hastanemizde mevcut Carestream Marka CR 975/Max Model CR Kaset Tarayıcı Cihazına uyumlu ve orijinal olmalıdır.
- 2) Sensörler cihazda mevcut Cassette Handling Assembly üzerindeki yuvasına oturacak şekilde tasarlanmış olup herhangi modifikasyon gerektirmeyecektir.
- 3) Sensörler takıldıktan sonra cihaz üzerindeki kaset yürütme mekanizmasında testleri yapılacak kasetler elle müdahale olmadan cihaz içerisine sorunsuz girip çıkmasını sağlayacaktır.
- 4) Teklif verecek firma uhdesinde kalan parçaları cihaza takıp sorunsuz bir şekilde çalıştıracaktır.
- 5) Değişecek yedek parçalar, cihazın orijinal görüntüsü ve işlevini bozmayacak şekilde olacaktır.
- 6) Arıza veya Bakım sonrası İdare söz konusu Tıbbi Cihazı 72 saat süre ile cihaz çalıştırılarak gözlem altına alır.
- 7) Gözlem süresi içinde aynı arızanın tekrarlamaması durumunda onarım kabul edilmiş olur.
- 8) Gözlem süresi içinde aynı arızanın tekrarlaması durumunda veya arıza giderme esnasında oluşan başka bir arıza sebebiyle onarım geçersiz kabul edilir.

**GARANTİ ŞARTLARI:**

- a) Temin edilen yedek parça ve işçilik için 1 (bir) yıl garanti verilecektir. Bu süre içinde aynı parçada sorun çıkması durumunda firma ücretsiz olarak parçayı temin ve montajla yükümlüdür.
- b) Firmanın uzaktan veya direk olarak Tıbbi cihaza müdahalesi, hatalı yedek parça kullanımı v.b. sebeplerle doğacak zarar ve ziyanın ile işletme zararlarını karşılanmasından sorumludur.
- c) Bakım ve onarımı yapılan Tıbbi cihaza ait Bakım prosedürleri madde madde servis tutanağına işlenecek, mahallinde bir fiil bulunması zorunlu bölümün görevlisi ve Klinik Mühendislik görevlisi ile Firma elemanı tarafından imzalanacaktır.

  
FİKRET ÖNCÜ

  
Ayhan ÇEVİK  
Sağlık Memuru

  
Garbi ERDEM  
Gevaş Devlet Hastanesi  
T.K.K.Y.


d) Firma bakım esnasında, firma personelinin dozimetre kullanımı, can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

e) Kusurlu ambalajlama veya montaj dolayısıyla hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar ya da montaj sırasında Firmanın kusurundan dolayı hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar, bütün masraflar Firmaya ait olmak üzere ücretsiz olarak değiştirilecektir.

FIRAT ÖNCÜ  
Radyoloji Sorumlu Tehnisi




Ayhan GEYİK  
Sağık Memuru



Garbi ERDEM  
Geyaş Devlet Hastanesi  
T.K.K.



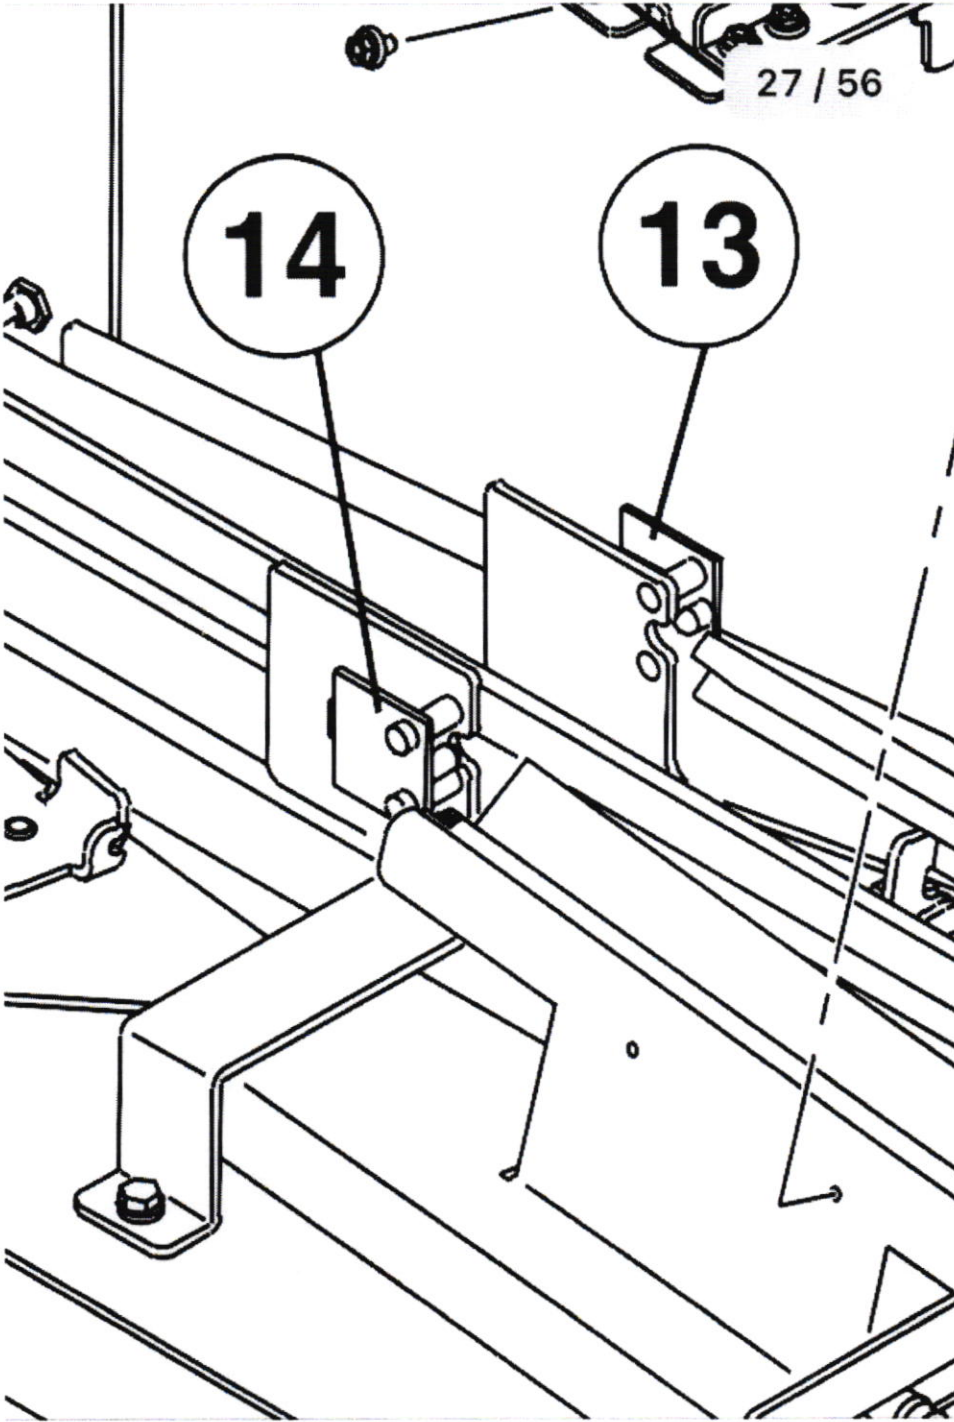

FKAT ÖNCE  
Kategori: tekniker zorluklu  
*[Signature]*

Ayhan GEVİK  
Sağlık Memuru

GARİ ERDEM  
T.K.M.Y.  
Geveş Devir Hastanesi  
*[Signature]*